

OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Usl Umbria 2 - NUMERO GARA ANAC 8598762.

VERBALE DI GARA del 3 APRILE 2023

In data 3 Aprile 2023 alle ore 10:00 presso una sala dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni si sono riuniti, in seduta riservata, i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 22 Febbraio 2023, per procedere all'esame qualitativo della documentazione tecnica e della campionatura prodotta dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto indicata.

Sono presenti:

Dr. Jacopo Tesei – Dirigente Medico S.C. Radiologia – Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in qualità di Presidente di Commissione

Dr. Daniele Mazzucca – Dirigente Radiologo – Presidio di Foligno - Usl Umbria 2, in qualità di Membro

Dr. Lucio Bellantonio – Dirigente Medico S.C. Neuroradiologia – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Zampa – RUP.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà atto che sono pervenute offerte dalle Ditte di seguito indicate, che risultano ammesse al prosieguo della procedura:

- 1) Ditta ACTIVA SRL - P. IVA 01535310427 – lotti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39, 47, 51, 55, 59, 68
- 2) Ditta ALSE MEDICA SRL – P.IVA 01923301004 – lotti 19, 20, 24, 83, 84
- 3) Ditta BALT ITALY SRL – P.IVA 11570870961 – lotti 36, 38, 45, 46, 52, 57, 63, 77
- 4) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA – P.IVA 0803890151 – lotti 76, 79, 101
- 5) Ditta BETATEX SPA – P.IVA 00440180545 – lotti 19, 20, 22, 24, 84
- 6) Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA – P.IVA 11206730159 – lotti 25, 26, 75, 80, 82, 99
- 7) Ditta COLMA SRL – P.IVA 01178470479 – lotto 6
- 8) Ditta COOK ITALIA SRL – P.IVA 00847380961 – lotti 18, 66, 76, 85, 86, 90, 100
- 9) Ditta ENDOVASCULAR SERVICE SRL – P.IVA 09175331009 – lotti 81, 92
- 10) Ditta GADA ITALIA SPA – P.IVA 08230471008 – lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 48, 54, 66, 69, 70, 71, 98
- 11) Ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA – P.IVA 08082461008 – lotto 96



PuntoZero S.c.a r.l.
SEDE LEGALE
Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547
REA C.C.I.A.A. 250357
Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271
Fax 075.5003402
puntozeroscarl@pec.it
www.puntozeroscarl.it

- 12) Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL – P.IVA 01885550366 – lotti 19, 20, 24, 27, 70, 83, 84, 88, 98
- 13) Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA – P.IVA 09238800156 – lotti 33, 34, 38, 45, 49, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 89, 93, 96, 101
- 14) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL – P.IVA 07609020966 – lotto 96
- 15) Ditta NANUTECH SRL – P.IVA 08861201005 – lotto 65
- 16) Ditta NEOVASC SRL – P.IVA 12109171004 – lotti 18, 78
- 17) Ditta NEW TECH SRL – P.IVA 01009660422 – lotti 34, 44, 47, 58, 59, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 93, 104, 105
- 18) Ditta PAUL HARTMANN SPA – P.IVA 02136540230 – lotto 24
- 19) Ditta PHENOX ITALY SRL – P.IVA 03091530216 – lotti 49, 59, 60, 62, 67
- 20) Ditta STRYKER ITALIA SRL – P.IVA 06032681006 – lotti 37, 50, 53, 56
- 21) Ditta STUDIO PACINOTTI SRL – P.IVA 01171880428 – lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 27, 43, 44, 78, 79, 81, 83, 84, 94
- 22) Ditta SVAS BIOSANA SPA – P.IVA 01354901215 – lotti 19, 20, 24, 26, 79, 83, 84
- 23) Ditta TAU MEDICA SRL – P.IVA 01282550555 – lotti 1, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 40, 79, 91
- 24) Ditta TECNOSTIM SRL – P.IVA 05856601009 – lotti 26, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55, 65, 68, 98
- 25) Ditta VIOLATECH SRL – P.IVA 10077121001 – lotti 8, 15, 25, 69, 74, 76, 79, 80, 98, 102
- 26) Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – P.IVA 01364640233 – lotto 85.

Dopo di che, la Commissione Giudicatrice procede alla lettura della documentazione di gara, all'esame della documentazione prodotta dalle citate ditte e della relativa campionatura dei primi 50 lotti, al fine di verificare la sussistenza delle caratteristiche tecniche di minima richieste.

La Comm.ne, tenuto conto di quanto sopra, attribuisce alle offerte tecniche di ciascuna Ditta i relativi punteggi tecnici, secondo quanto previsto all'art. 7 "modalità di aggiudicazione" del Capitolato di gara, per le motivazioni riportate nelle allegate schede appositamente predisposte (All. A).

A conclusione dei lavori, la Commissione dà atto che risulta la situazione di seguito riepilogata:

LOTTO 1

DITTA PARTECIPANTE

TAU MEDICA SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 2

DITTA PARTECIPANTE

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

DM *RU* *LB* *[Signature]*

LOTTO 3

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 4

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 5

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA SRL

TAU MEDICA SRL

PUNTEGGIO

28,00 - ESCLUSA

44,00

LOTTO 6

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA SRL

COLMA SRL

GADA ITALIA SPA

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

32,00 - ESCLUSA

28,00 - ESCLUSA

70,00

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 7

DITTA PARTECIPANTE

ACTIVA SRL

GADA ITALIA SPA

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

32,00 - ESCLUSA

70,00

28,00 - ESCLUSA



LOTTO 8

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

GADA ITALIA SPA

70,00

STUDIO PACINOTTI SRL

36,00

VIOLATECH SRL

36,00

LOTTO 9

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

ACTIVA SRL

32,00 - ESCLUSA

GADA ITALIA SPA

70,00

STUDIO PACINOTTI SRL

28,00 - ESCLUSA

TAU MEDICA SRL

38,00

LOTTO 10

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

ACTIVA SRL

32,00 - ESCLUSA

GADA ITALIA SPA

70,00

STUDIO PACINOTTI SRL

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 11

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

ACTIVA SRL

32,00 - ESCLUSA

GADA ITALIA SPA

70,00

STUDIO PACINOTTI SRL

28,00 - ESCLUSA

M

D

B

X

LOTTO 12

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

70,00

34,00 - ESCLUSA

LOTTO 13

DITTA PARTECIPANTE

ACTIVA SRL

GADA ITALIA SPA

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

32,00 - ESCLUSA

70,00

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 14

DITTA PARTECIPANTE

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 15

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

TAU MEDICA SRL

VIOLATECH SRL

PUNTEGGIO

70,00

34,00 - ESCLUSA

34,00 - ESCLUSA

LOTTO 16

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 17

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

GADA ITALIA SPA

70,00

TAU MEDICA SRL

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 18

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

COOK ITALIA SRL

36,00

GADA ITALIA SPA

70,00

NEOVASC SRL

36,00

LOTTO 19

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

ALSE MEDICA SRL

46,00

BETATEX SPA

46,00

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL

70,00

STUDIO PACINOTTI SRL

52,00

SVAS BIOSANA SPA

52,00

LOTTO 20

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

ALSE MEDICA SRL

46,00

BETATEX SPA

46,00

MED-ITALIA BIOMDICA SRL

70,00

STUDIO PACINOTTI SRL

52,00

SVAS BIOSANA SPA

52,00

LOTTO 22

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO



BETATEX SPA	70,00
TAU MEDICA SRL	56,00

LOTTO 24

<u>DITTA PARTECIPANTE</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
ALSE MEDICA SRL	70,00
BETATEX SPA	46,00
MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	40,00
PAUL HARTMANN SPA	24,00 - ESCLUSA
STUDIO PACINOTTI SRL	38,00
SVAS BIOSANA SPA	42,00
TAU MEDICA SRL	48,00

LOTTO 25


<u>DITTE PARTECIPANTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70,00
VIOLATECH SRL	34,00 - ESCLUSA

LOTTO 26

<u>DITTE PARTECIPANTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70,00
SVAS BIOSANA SPA	34,00 - ESCLUSA
TECNOSTIM SRL	ESCLUSA

LOTTO 27

<u>DITTE PARTECIPANTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	70,00





STUDIO PACINOTTI SRL

52,00

TECNOSTIM SRL

52,00

LOTTO 33

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

MEDTRONIC ITALIA SPA

70,00

LOTTO 34

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

MEDTRONIC ITALIA SPA

66,00

NEW TECH SRL

28,00 - ESCLUSA

TECNOSTIM SRL

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 36

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

BALT ITALY SRL

70,00

LOTTO 37

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

STRYKER ITALIA SRL

70,00

LOTTO 38

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

BALT ITALY SRL

70,00

MEDTRONIC ITALIA SPA

ESCLUSA

TECNOSTIM SRL

ESCLUSA

LOTTO 39

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 40

DITTE PARTECIPANTI

TAU MEDICA SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 42

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 43

DITTE PARTECIPANTI

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 44

DITTE PARTECIPANTI

NEW TECH SRL

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

70,00

32,00 - ESCLUSA

LOTTO 45

DITTE PARTECIPANTI

BALT ITALY SRL

MEDTRONIC ITALIA SPA

TECNOSTIM SRL

PUNTEGGIO

70,00

18,00 - ESCLUSA

32,00 - ESCLUSA



LOTTO 46

DITTE PARTECIPANTI

BALT ITALY SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 47

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA SRL

NEW TECH SRL

TECNOSTIM SRL

PUNTEGGIO

70,00

70,00

32,00 - ESCLUSA

LOTTO 48

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 49

DITTE PARTECIPANTI

MEDTRONIC ITALIA SPA

PHENOX ITALY SRL

PUNTEGGIO

70,00

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 50

DITTE PARTECIPANTI

STRYKER ITALIA SRL

PUNTEGGIO

70,00

Il presente verbale e tutta la documentazione cartacea allegata allo stesso viene scannerizzata e il formato PDF viene inoltrato a cura del segretario verbalizzante ai Componenti della Commissione Giudicatrice che hanno assistito in videoconferenza – Dott. Lucio Bellantonio e Dott. Daniele Mazzuca – con posta elettronica, ove ciascuno appone la propria firma e restituisce il verbale medesimo, con la stessa modalità (posta elettronica), al segretario verbalizzante (RUP) della



procedura. I restanti componenti firmano in originale, essendo stati presenti e collegati nella medesima sede del RUP e segretario verbalizzante.

Da ultimo, la Commissione dà atto che le buste contenenti le offerte economiche rimangono chiuse e sigillate nel programma informatico piattaforma Net4market.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione decide di riaggiornarsi a data da concordare per esaminare i restanti lotti.

Letto confermato e sottoscritto.

Dr. Jacopo Tesei – Presidente

Dr. Daniele Mazzuca – Membro

Dr. Lucio Bellantonio – Membro

Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante

LOTTO 1	PUNTEGGIO MAX	DITTA TAU MEDICA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' DEL MATERIALE (RACCORDO TRASPARENTE PER IL REFLUSSO)	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
ATRAUMATICITA'	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 2	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA ITALIA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' DEL FLUSSO INFUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SCOREVOLEZZA	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15
GAMMA CONFORMAZIONE E PERSONALIZZAZIONI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CONTROLLO TORSIONE	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 3	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA ITALIA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' DEL FLUSSO INFUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SCOREVOLEZZA	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15
GAMMA CONFORMAZIONE E PERSONALIZZAZIONI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CONTROLLO TORSIONE	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 4	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA ITALIA		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
QUALITA' DEL FLUSSO INFUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
SCORREVOLEZZA	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15	
GAMMA CONFORMAZIONE E PERSONALIZZAZIONI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	
CONTROLLO TORSIONE	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15	
PUNTEGGIO TOTALE		70		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 5	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA TAU MEDICA		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
GRADO DI IDROFILA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	DISCRETA IDROFILA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA IDROFILA
SCORREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 18	BUONA SCORREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETA RISPOSTA ALLA TORSIONE
MODELLABILITA' DELL'ESTREMITA' DISTALE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0 0	NON MODELLABILE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	MODELLABILE
PUNTEGGIO TOTALE			28			44	

mm

BB

SB

LOTTO 6	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA COLMA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI		
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE 0,6	PUNTEGGIO 12	ECCELLENTE IDROFILIA	COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8	DISCRETA IDROFILIA	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 20	COPOLIMERO SINTETICO IDROFILO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8	DISCRETA IDROFILIA
SCORREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 30	ALTA SCORREVOLEZZA DURANTE L'AVANZAMENTO NEI VASI TOTRITUOSI	COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 20		COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALE		32			28			70			28		





LOTTO 7	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE	PUNTEGGI		COEFFICIENTE	PUNTEGGI		COEFFICIENTE	PUNTEGGI	
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE	0,6	BUONA IDROFILIA	COEFFICIENTE	1	COPOLIMERO SINTETICO IDROFILO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA IDROFILIA
		PUNTEGGIO	12		PUNTEGGIO	20		PUNTEGGIO	8	
SCORREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE	1	ECCELLENTE SCORREVOLEZZA DURANTE L'AVANZAMENTO NEI VASI TORTUOSI	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA SCORREVOLEZZA
		PUNTEGGIO	12	A	PUNTEGGIO	30		PUNTEGGIO	12	
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA RISPOSTA ALLA TORSIONE	COEFFICIENTE	1		COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA RISPOSTA ALLA TORSIONE
		PUNTEGGIO	8		PUNTEGGIO	20		PUNTEGGIO	8	
PUNTEGGIO TOTALE		32			70			28		

LOTTO 8	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO			COEFFICIENTE / PUNTEGGIO			COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		
SCOREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20			COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 4	SUFFICIENTE SCOREVOLEZZA		COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 4	SUFFICIENTE SCOREVOLEZZA	
CONFEZIONAMENTO E IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	ECCELLENTE ATRAUMATICITA'		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	DISCRETA ATRAUMATICITA'		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	DISCRETA ATRAUMATICITA'	
MANOVRAABILITA' : RISPOSTA ALLA SPINTA	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	RISPOSTA ALLA SPINTA COSTANTE		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 4	DISCRETA MANOVRAABILITA'		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 4	DISCRETA MANOVRAABILITA'	
GAMMA CONFORMAZIONE PUNTE E LUNGHEZZE	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		
PUNTEGGIO TOTALE		70			36			36		

22

23

24

25

LOTTO 9	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE	DITTA TAU MEDICA		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI		
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 12		BUONA IDROFILIA	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20		COPOLIMERO SINTETICO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETA IDROFILIA	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 12		BUONA IDROFILIA
SCOREVOL EZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12		DISCRETA SCOREVOL EZZA	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		ECCELLENT SCOREVOLE ZZA	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12		DISCRETA SCOREVOLEZZA	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 18		BUONA SCOREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20			COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALE		32			70			28			38		

LOTTO 10	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE	0,6	BUONA IDROFILIA	COEFFICIENTE	1	COPOLIMERO SINTETICO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA IDROFILIA
		PUNTEGGIO	12		PUNTEGGIO	20		PUNTEGGIO	8	
SCOREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA SCOREVOLEZZA	COEFFICIENTE	1	ECCELLENTE SCOREVOLEZZA	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA SCOREVOLEZZA
		PUNTEGGIO	12		PUNTEGGIO	30		PUNTEGGIO	12	
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE	1		COEFFICIENTE	0,4	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
		PUNTEGGIO	8		PUNTEGGIO	20		PUNTEGGIO	8	
UNTEGGIO TOTAL			32			70			28	

am

de

5

8

LOTTO 11	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA IDROFILIA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COPOLIMERO SINTETICO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA IDROFILIA
SCORREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTE SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALI		32			70			28		

LOTTO 12	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
SCOREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ECCELLENTE SCOREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA SCOREVOLEZZA
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ECCELLENTE ATRAUMATICITA'	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA TRAUMATICITA'
GAMMA CONFORMAZIONE PUNTE E LUNGHEZZE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
CONTROLLO TORSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
CAPACITA' DI SUPERARE L'OCCCLUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ECCELLENTE CAPACITA' DI OLTREPASSARE OCCCLUSIONI	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETA CAPACITA' DI SUPERARE OCCCLUSIONI
PUNTEGGIO TOTALE		70			34		

LOTTO 13	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA IDROFILIA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COPOLIMERO SINTETICO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA IDROFILIA
SCOREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCOREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTE SCOREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCOREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALE		32			70			28		

LOTTO 14	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
SCOREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
GAMMA CONOFORMAZIONE PUNTE E LUNGHEZZE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CONTROLLO TORSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CAPACITA' DI SUPERARE L'OCCCLUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 15	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA		NOTE	DITTA TAU MEDICA		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGIO			COEFFICIENTE/PUNTEGGIO			COEFFICIENTE/PUNTEGGIO		
RAPPORTO CALIBRO - PORTATA	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		
RASTREMATURA E ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	ECCELLENTE RASTREMATURA. SISTEMA ANCORAGGIO "SNAP - ON"		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	DISCRETA ATRAUMATICITA'	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	MINORE ATRAUMATICITA'		
RESISTENZA AL KINKING	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	ECCELLENTE RESISTENZA AL KINKING		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	DISCRETA RESISTENZA AL KINKING	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	RIDOTTA RESISTENZA AL KINKING		
SCORREVOLEZZA	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	ECCELLENTE SCORREVOLEZZA		COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6	BUONA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6	DISCRETA SCORREVOLEZZA		
AMPIEZZA GAMMA	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 2	NON DISPONIBILE CON AGO DA PUNTURA DOTATO DI MANDRINO METALLICO CAVO E CANNULA DI PLASTICA	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 2	NON DISPONIBILE CON AGO DA PUNTURA DOTATO DI MANDRINO METALLICO CAVO E CANNULA DI PLASTICA		
PUNTEGGIO TOTALE		70			34		34			

LOTTO 16	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
RASTREMATURA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
RESISTENZA AL KINKING	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CAPACITA' DI PENETRAZIONE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 17	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA		NOTE	DITTA TAU MEDICA		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
RASTREMATURA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ECCELLENTE RASTREMATURA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETA RASTREMATURA
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ECCELLENTE ATRAMAUTICITA' SISTEMA DI ANCORAGGIO "SNAP - ON"	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA ATRAUMATICITA'
RESISTENZA AL KINKING	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETA RESISTENZA AL KINKING
CAPACITA' DI PENETRAZIONE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA CAPACITA' DI PENETRAZIONE
PUNTEGGIO TOTALE		70			28		

LOTTO 18	PUNTEGGIO MAX	DITTA COOK		NOTE	DITTA GADA		NOTE	DITTA NEOVASC		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO			COEFFICIENTE / PUNTEGGIO			COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		
STABILITA' E SUPPORTO	30	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12		DISCRETO SUPPORTO DISTALE	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12		DISCRETO SUPPORTO DISTALE
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETA ATRAUMATICITA'	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20			COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETA ATRAUMATICITA'
GAMMA E LUNGHEZZE	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		
ADATTAMENTO ANATOMIA VASCOLARE	10	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6		BUON ADATTAMENTO ALL'ANATOMIA VASCOLARE	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	ECCELLENTE RESISTENZA AL KINKING		COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6		BUON ADATTAMENTO ALL'ANATOMIA VASCOLARE
PUNTEGGIO TOTALE		36			70			36		

LOTTO 19	PUNTEGGIO MAX	DITTA ALSE MEDICA		NOTE	DITTA BETATEX		NOTE	DITTA MED-ITALIA		STUDIO PACINOTTI		DITTA SVAS-BIOSANA		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 18		MATERIALE IN PLASTICA DI BUONA RESISTENZA
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		
CORRISPONDE NZA CARATTERISTI CHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	NON PRESENTE RUBINETTO FLOW SWITCH 1 VIA, CIOTOLE DELLO STESSO COLORE		COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	NON PRESENTE RUBINETTO FLOW SWITCH 1 VIA		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12		CIOTOLE NON DISTINGUIBILI PER COLORE	COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 24		RUBINETTO A SCATTO DI OTTIMO INGOMBRO
PUNTEGGIO TOTALE		46			46			70		52		52		

LOTTO 20	PUNTEGGIO MAX	DITTA ALSE MEDICA		NOTE	DITTA BETATEX		NOTE	DITTA MED-ITALIA		STUDIO PACINOTTI		NOTE	DITTA SVAS-BIOSANA		NOTE MATERIAL
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI		
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 18	E IN PLASTICA DI BUONA RESISTENZA	
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTI	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	NON PRESENTE RUBINETTO A FLOW SWITCH 1 VIA, CIOTOLE DELLO STESSO COLORE		COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	NON PRESENTE RUBINETTO A FLOW SWITCH 1 VIA		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12	CIOTOLE NON DISTINGUIBILI PER COLORE			COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 24	RUBINETTO A SCATTO DI OTTIMA INGOMBRO	
PUNTEGGIO TOTAL		46			46			70	52			52			

LOTTO 22	PUNTEGGIO MAX	DITTA BETATEX		DITTA TAU MEDICA		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 18	BUONA QUALITA'
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	OTTIMO CONFEZIONA MENTO
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	
PUNTEGGIO TOTALE		70		56		

LOTTO 24	PUNTEGGIO MAX	DITTA ALSE MEDICA		NOTE	DITTA MED-ITALIA		NOTE	DITTA PAUL HARTMANN		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12	DISCRETA QUALITA' DEI MATERIALI	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	LA QUALITA' DEI TELI ASSORBENTI E' SUFFICIENTE		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12		
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 4		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 4			COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6		
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	SUFFICIENTE, TELO 160X150 CM CON FORO 35X25 CUFFIA IN PLASTICA COPRISTRUMENTI 100X50 CM	
PUNTEGGIO TOTALE		70	46		40			24		

LOTTO 24	PUNTEGGIO MAX	STUDIO PACINOTTI		NOTE	DITTA SVAS BIOSANA		NOTE	DITTA TAU MEDICA	
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI	
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 24			COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	LA QUALITA' DEI TELI ASSORBENTI E' SUFFICIENTE		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12	
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 8			COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6			COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 4	
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	TELO PAZIENTE 230X350 CM CIOTOLA MEDIA 400 ML		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	
PUNTEGGIO TOTALE		38			42			46	

LOTTO 25	PUNTEGGIO MAX	DITTA BOSTON		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
QUALITA' DEI MATERIALI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
PRECISIONE APERTURA E CHIUSURA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTE PRECISIONE GRAZIE A MECCANISMO A SCATTO	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA PRECISIONE
MANEGGEVOLEZZA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTE MANEGGEVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	NON PRESENTE MECCANISMO A SCATTO
PUNTEGGIO TOTALE		70			34		


LOTTO 26	PUNTEGGIO MAX	DITTA BOSTON		NOTE	DITTA SVAS - BIOSANA		NOTE	DITTA TECNOSTIM	
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI	NOTE
QUALITA' DEI MATERIALI	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			ESCLUSA	
PRECISIONE APERTURA E CHIUSURA	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 18				ASSENZA DI MECCANISMO A SCATTO
MANEGGEVOLEZZA	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	DIMENSIONI RIDOTTE		COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	NOTEVOLE INGOMBRO			ASSENZA DI MECCANISMO A SCATTO
PUNTEGGIO TOTALE		70			34				

LOTTO 27	PUNTEGGIO MAX	DITTA MED - ITALIA		STUDIO PACINOTTI		DITTA TECNOSTIM	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12
CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
MANEGGEVOLEZZA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
PUNTEGGIO TOTALE		70		52		52	

LOTTO 33	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
STABILITA' E SUPPORTO NELL'ARCO AORTICO	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
ATRAUMATICITA' DELL'ESTREMITA' DISTALE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
AMPIEZZA DEL LUME	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 34	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC		DITTA NEW TECH		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6	
LUNGHEZZA DELL'ESTREMITA' SUPERMORBIDA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	
AMPIEZZA DEL LUME	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	NON DISPONIBILE AMPIEZZA LUME 0,058 E 0,072	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	NON DISPONIBILE AMPIEZZA LUME 0,058 E 0,072
STABILITA' E SUPPORTO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	
PUNTEGGIO TOTALE		66		28			28		

LOTTO 36	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALI ITALY	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
STABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
MANEGGEVOLEZZA DI SGONFIAGGIO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70

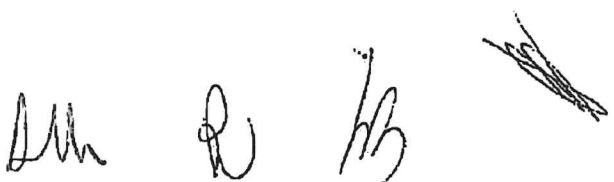

LOTTO 37	PUNTEGGIO MAX	DITTA STRYKER	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
ATRAUMATICITA' PALLONE	20	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	20
TRACKABILITY	20	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	20
CONTROLLO	10	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	10
VELOCITA' DI SGONFIAGGIO	10	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	10
RANGE DI GAMMA	10	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	10
PUNTEGGIO TOTALE			70

2/11

2

1/3

1/3

LOTTO 38	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT		DITTA MEDTRONIC		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
OPACITA' IN FLUOROSCOPIA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ESCLUSA					
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20						
AMPIEZZA DI GAMMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		NON DISPONIBILE A BASSA VISCOSITA'		ESCLUSA	NON DISPONIBILE A BASSA VISCOSITA'	
VISCOSITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10						
CAPACITA' DI PENETRAZIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10						
PUNTEGGIO TOTALE		70							







LOTTO 39	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
CONFEZIONAMENTO (MATERIALE PRECARICATO)	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
MANEGGEVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
VISCOSITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 40	PUNTEGGIO MAX	DITTA TAU MEDICA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
TROMBOGENICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FACILITA' D'USO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
VISIBILITA' IN SCOPIA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 42	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' EMBOLIZZANTE	10	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	10
RANGE DI DIAMETRO PARTICELLE	20	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	20
FACILITA' DI SOMMINISTRAZIONE	20	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	20
PRECISIONE DI EMBOLIZZAZIONE TARGET	10	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	10
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	10
PUNTEGGIO TOTALE			70

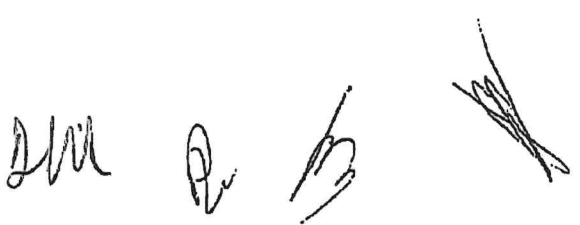

LOTTO 43	PUNTEGGIO MAX	STUDIO PACINOTTI	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' EMBOLIZZANTE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
RANGE DI DIAMETRO PARTICELLE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FACILITA' DI SOMMINISTRAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PRECISIONE DI EMBOLIZZAZIONE TARGET	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 44	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEW TECH		STUDIO PACINOTTI	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
FLESSIBILITA' ADATTAMENTO ANATOMIA VASI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12
AMPIEZZA GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 2
NAVIGABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 2
VISIBILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8
TROMBOGENICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8
PUNTEGGIO TOTALE		70		32	

DM

72

BS

11

LOTTO 45	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT		DITTA MEDTRONIC		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
ATRAUMATICITA' ALL'INTERNO DELL'ANEURISMA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	DISTACCO MECCANICO	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	ELEVATA TRAUMATTI CITA'
MANEGGEVOLEZZA E NAVIGABILITA' ALL'INTERNO DEL MICROCATETERE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	
SICUREZZA NELLA RETRAIBILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 4	DISTACCO MECCANICO	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA SICUREZZA NELLA RETRAIBILI TA'
PUNTEGGIO TOTALE	70		70		18			32	

LOTTO 46	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALI	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
COMPATIBILITA' CON MICROCATETERI 1.2 F	40	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 40
MANEGGEVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
OPACITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 47	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		DITTA NEW TECH		DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI		
ATRAUMATICITA' ALL'INTERNO DELL'ANEURISMA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	ELEVATA TRAUMATICITA'
MANEGGEVOLEZZA E NAVIGABILITA' ALL'INTERNO DEL MICROCATETERE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	
SICUREZZA NELLA RETRAIBILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA SICUREZZA NELLA RETRAIBILITA'
PUNTEGGIO TOTALE	70	70		70		32		

21/11

21/11

21/11

21/11

LOTTO 48	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
FLESSIBILITA' ADATTAMENTO ANATOMIA VASI	20	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	20
AMPIEZZA GAMMA	10	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	10
NAVIGABILITA'	10	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	10
VISIBILITA'	10	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	10
TROMBOGENICITA'	20	COEFFICIENTE	1
		PUNTEGGIO	20
PUNTEGGIO TOTALE		70	

LM

20

B

LOTTO 49	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC		NOTE	DITTA PHENOX		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
ATRAUMATICITA' ALL'INTERNO DELL'ANEURISMA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISTACCO NON AGEVOLE
MANEGGEVOLEZZA E NAVIGABILITA' ALL'INTERNO DEL MICROCATETERE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISTACCO NON AGEVOLE
SICUREZZA NELLA RETRAIBILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISTACCO NON AGEVOLE
PUNTEGGIO TOTALE	70	70			28		

LOTTO 50	PUNTEGGIO MAX	DITTA STRYKER	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
ATRAUMATICITA' ALL'INTERNO DELL'ANEURISMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
MANEGGEVOLEZZA E NAVIGABILITA' ALL'INTERNO DEL MICROCATETERE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
SICUREZZA NELLA REATRAIBILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

